

PLATELIA™ RABIES II KIT

ad Usum Veterinarium

192 TESTS

Ref.: 355-0180


KIT PENTRU DETECTIA SI TITRAREA IN VITRO A IgG ANTI GLICOPROTEINA VIRUSULUI RABIC IN SERUL PROVENIT DE LA CAINI, PISICI SI VULPI.

Totii reactivii produsi si comercializati sunt supusi unui sistem complet de control al calitatii, incepand cu receptia materialelor brute si pana la comercializarea finala a produsului. Fiecare lot este supus unui control de calitate si este eliberat spre vanzare numai daca este in conformitate cu criteriile de acceptare



Potrivit cu scopul validarii si certificat de catre OIE
Numar de inregistrare: 20070101

Manual de utilizare

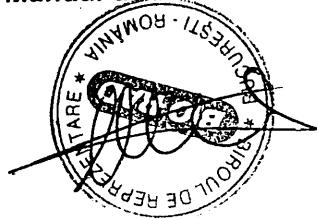


1

BIO-RAD

CUPRINS

- 1 - DOMENIUL DE UTILZARE AL TRUSEI
- 2 - INTERESUL ASUPRA TRUSEI PLATELIA™ RABIES II
- 3 - PRINCIPIUL TESTULUI OF THE PLATELIA™ RABIES II
- 4 - COMPOZITIA TRUSEI OF THE PLATELIA™ RABIES II
- 5 - PREPARAREA SOLUTIILOR DE REACTIVI
- 6 - CONDITII DE STOCARE - VALABILITATE
- 7 - PROBE
- 8 - PROTOCOLUL DE TESTARE
- 9 - CALCULAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR
- 10 - LIMITELE TESTULUI
- 11 - ECHIPAMENTE SI MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE IN TRUSA
- 12 - MASURI DE PRECAUTIE
- 13 - BIBLIOGRAFIE

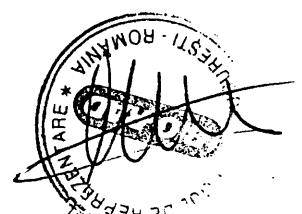

BIO-RAD

1 - DOMENIUL DE UTILIZARE AL TRUSEI

Trusa PLATELIA™ RABIES II este un test de diagnostic *in vitro* de tip ELISA care permite detectia si titrarea IgG anti-glicoproteina virusului rabic in serul de animale (caini, pisici si vulpi).

2 - INTERESUL ASUPRA TRUSEI PLATELIA™ RABIES II

Rabia este una dintre cele mai vechi boli virale despre care se stie ca afecteaza atat oamenii, cat si animalele. Virusul rabiei este un virus puternic neurotrop si cauzeaza de cele mai multe ori o encefalita fatala la mamifere. Virusul este transmis in principal prin intermediul salivei, in cazul muscaturilor de catre animale infectate. Programele de imunizare si control pentru protejarea populatiilor animale fata de virusul rabic au condus la eliminarea bolii in mai multe tari vest-europene si in unele tari din America de Sud.

Incepand cu data de 3 Iulie 2004 se aplica o noua lege europeana care reglementeaza traficul international al carnivorelor domestice din tari in care exista cazuri de rabie in tari libere de rabie. Carnivorele domestice pot calatori daca serul lor contine cel putin 0.5 IU/ml (Unitati Internationale /ml) de anticorpi neutralizanti anti-rabie.

Titrarea anticorpilor anti-rabie are cateva aplicatii practice:

- ♦ Serologia individuala in vederea comertului international: anticorpii anti-rabie se masoara in laboratoare specializate pentru a determina imunitatea animalelor vaccinate (pisici si caini). Un nivel al anticorpilor mai mare sau cel putin egal cu 0.5 IU/ml este considerat de catre expertii OIE ca nivel acceptabil de seroconversie, de la care vaccinarea este considerata ca reusita.
- ♦ Confirmarea statusului de vaccinare in cursul unei campanii de vaccinare: controlul anticorpilor anti-rabie permite evaluarea indirecta a eficientei vaccinarii orale in cazul animalelor salbatice (vulpi).

3 – PRINCIPIUL TESTULUI PLATELIA™ RABIES II

PLATELIA RABIES II este o tehnica imuno-enzimatica pentru detectia anticorpilor anti-glicoproteina virusului rabic. Acest test poate fi efectuat pe ser provenind de la unele specii de animale – caine, pisica si vulpe.


Acest test se bazeaza pe utilizarea unei tehnici imunoenzimatiche in faza solida, cunoscuta ca tehnica ELISA indirecta. O microplaca este invelita cu glicoproteina virală extrasă din membrana virală inactivată și purificată. Conjugatul enzimatic este format din proteina A de la *Staphylococcus aureus* cuplată cu peroxidază. Martorii pozitivi, calibrati fata de standard OIE permit determinarea calitativa sau cantitativa a titrului anticorpilor anti-rabie in ser.

Implementarea testului cuprinde urmatoarele etape de reactie:

- 1) Serurile de testat, precum si Martorii Pozitivi calibrati sau Standardele de Cuantificare sunt distribuite in godeurile invelite cu glicoproteina ale microplacilor din trusa. In urma unei etape de incubare de o ora la 37°C, anticorpii anti-rabie prezenti in probe se lega la

godeurile invelite cu glicoproteina ale microplaci. Dupa incubare, anticorpii care au ramas nelegati, precum si alte proteine serice sunt inlaturate prin spalari.

- 2) Conjugatul (proteina A marcata cu peroxidaza) se adauga in godeurile microplaci. In timpul unei a doua etape de incubare de o ora la 37°C, proteina A marcata se leaga de complexele anticorpi anti-rabie – antigen fixate de godeurile microplaci. Conjugatul ramas liber este inlaturat prin spalari.
- 3) Prezenta complexelor imune este demonstrata prin adaugarea unei solutii continand substrat pentru peroxidaza si o substanta cromogena, ceea ce initiaza o reacție de dezvoltare a culorii.
- 4) Dupa o incubare de 30 min. la temperatura camerei, reactia enzimatica este stopata prin adaugarea unei solutii H₂SO₄ 1N. Densitatea optica a citirii obtinuta cu un spectrofotometru setat la 450 nm, cu citire de referinta la 620 nm este proportionala cu cantitatea de anticorpi anti-rabie prezenti in proba. Se realizeaza o curba standard pe baza standardelor de Cuantificare (S1 - S6), care se obtin prin dilutii seriale ale Martorilor Pozitivi calibrati R4b.
Valorile densitatii optice pentru probele necunoscute sunt comparate cu valorile Martorilor Pozitivi. Titrurile serurilor in teste de cuantificare pot fi obtinute dupa citirea directa pe curba standard si sunt exprimate ca Unitati Echivalente la 1ml (EU/ml), unitate echivalenta cu unitatile echivalente definite in seroneutralizare.

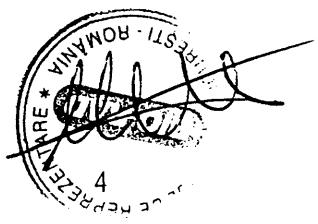


4 – COMPOZITIA TRUSEI PLATELIA™ RABIES II

Totii reactivii sunt destinati exclusiv diagnosticului veterinar *in vitro*.

Trusa contine o cantitate de reactivi suficiente pentru 2 x 96 teste. Pe fiecare placa pot fi analizate 90 probe in cazul in care se realizeaza o determinare calitativa. Daca se doreste un sistem cantitatativ, pana la 80 probe pot fi cuantificate precis pentru anticorpi anti-rabici.

ETICHETARE	TIP DE REACTIV	PREZENTARE
R1	Microplaca: 12 barete de 8 godeuri sensibilizate cu glicoproteina virusului rabic	2 placi
R2	Solutie de spalare: tampon Tris-NaCl, 10x Conservant : Proclin™300 (0,01%)	1 sticla (250 ml)
R3	Martor Negativ: Martor areactiv TRIS-EDTA Conservant : Proclin™300 (0,1%)	1 flacon (0.6 ml)
R4a	Martor Pozitiv 0,5 EU/ml: martor pozitiv calibrat 0.5 EU / ml Tampon glicina continand BSA si ser de caine cu IgG anti-rabie Culoare albastra. Conservant: Proclin™300 (0,1%)	1 flacon (0.6 ml)
R4b	Martor Pozitiv 4 EU/ ml: martor pozitiv calibrat 4 EU/ml Tampon glicina continand BSA si ser de caine cu IgG anti-rabie Culoare albastra. Conservant: Proclin™300 (0,1%)	1 flacon (0.6 ml)
R6	Diluant pentru proba: Tampon TRIS - EDTA gata de utilizare pentru diluarea probei. Culoare rosie. Conservant: Proclin™300 (0,1%)	2 flacoane (2 x 125 ml)
R7	Conjugat: Solutie continand Proteina A – Peroxidaza si proteina bovina purificata. Solutie de 10x concentrata. Culoare verde. Conservant: Proclin™300 (0,1%)	1 flacon (3 ml)
R8	Tampon substrat pentru peroxidaza: Solutie de acid citric si acetat de sodiu continand 0,015%H ₂ O ₂ si 4% dimetilsulfoxid (DMSO)	1flacon (60 ml)
R9	Cromogen: solutie 0.25% tetrametilbenzidina (TMB)	1 flacon (5 ml)
R10	Solutie de Stopare: solutie acid sulfuric 1N	1flacon (28 ml)
	Folie adeziva pentru microplaci	6

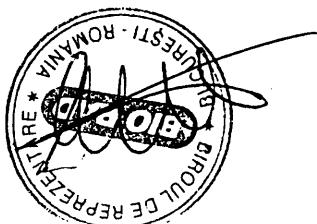

5 – PREPARAREA REACTIVILOR

Nota:

Inainte de utilizare reactivii trebuie lasati sa ajunga la temperatura camerei (+18 pana la +30°C) timp de 30 de minute.

Omogenizati reactivii prin agitare usoara inainte de deschiderea flacoanelor.



1. Reactivi gata de utilizare

- ◆ **Microplaci (R1):** Inainte de deschiderea ambalajului impachetat sub vid, se recomanda lasarea microplacii sa atinga temperatura camerei (intre +18°C si +30°C) in ambalaj sau protector, pentru a evita condensarea apei in godeuri. Baretele neutilizate vor fi imediat introduse in pachet, iar pachetul se va sigila dupa eliminarea aerului, apoi se va stoca la o temperatura intre +2°C - +8°C.
- ◆ Diluant pentru proba (R6)
- ◆ Solutie de Stopare (R10)

2. Reactivi care trebuie reconstituiti

- ◆ Solutie de spalare (R2)

Diluati solutia 1/10 in apa distilata (de exemplu 100 ml reactiv R2 in 900 ml apa distilata).

Pentru o placă sunt necesari 500 ml.

- ◆ Martor negativ (R3)

Diluati solutia 1/100 in R6

- ◆ Martor pozitiv 0,5 EU/ml (R4a)

Diluati martorul pozitiv R4a 1/100 in R6

- ◆ Martor pozitiv 4 EU/ml (R4b)

Diluati martorul pozitiv R4b 1/100 in R6

- ◆ Conjugat (R7)

Solutia este de 10x concentrata. Pentru a prepara solutia diluata de conjugat, adaugati 1 volum de solutie concentrata de conjugat la 9 volume de solutie de spalare (R2) preparata 1X. Pentru o microplaca intreaga sunt necesari 11 ml.

- ◆ Solutie de developare enzimatica (R8 + R9).

Diluati reactivul R9 1/11 in reactivul R8 (de exemplu: 0.1 ml reactiv R9 in 1 ml reactiv R8), tinand cont de faptul ca 11 ml solutie de revelare a reactiei enzimatiche sunt suficienti pentru 1 microplaca. Omogenizati usor. Evitati utilizarea unui agitator tip Vortex.



3. Prepararea Standardelor de Cuantificare pentru un test cantitativ

Fiecare test cantitativ care utilizeaza trusa PLATELIA™ RABIES II ar trebui sa includa 6 Standarde de Cuantificare, de la S1 la S6.

Martorul pozitiv calibrat R4b (4 EU/ml) corespunde Standardului de Cuantificare S6. Standardele de cuantificare S1-S5 se prepara prin dilutii seriale ale reactivului R4b. Dilutiile se efectueaza cu ajutorul diluantului pentru proba (reactiv R6).


Standarde de Cuantificare		Concentratii obtinute prin dilutii seriale ale Martorului Pozitiv R4b
S6	Reactiv R4b diluat la 1/100	4 EU/ml
S5	S6 diluat la ½	2 EU/ml
S4	S5 diluat la ½	1 EU/ml
S3	S4 diluat la ½	0.5 EU/ml
S2	S3 diluat la ½	0.25 EU/ml
S1	S2 diluat la ½	0.125 EU/ml

6 – CONDITII DE STOCARE - VALABILITATE

Toate componente ale trusei PLATELIA™ RABIES II kit se stocheaza la o temperatura intre +2° si +8°C si pot fi utilizate pana la data de expirare indicate in trusa. Reactivul R2 (10 X) poate fi pastrat la o temperatura intre +2°C si +25°C inainte de reconstituire.

Valabilitatea reactivilor dupa preparare este urmatoarea:

	Reactiv	Observatii	Valabilitate
R1	Microplaca	Dupa deschiderea ambalajului cu banda de sigilare, baretele care nu au fost utilizate trebuie introduse inapoi in ambalaj, iar ambalajul trebuie resigilat. Substanta deshidratanta trebuie sa ramana in ambalaj.	1 luna la +2°C pana la +8°C
R2	Solutie de spalare diluata		2 saptamani la +2°C pana la +8°C
R7	Solutie de conjugat diluata	Se recomanda ca solutia diluata de conjugat sa fie utilizata imediat	8 ore la +2°C pana la +8°C
R8 + R9	Solutie de developare reconstituita		6 ore la temperatura camerei (+18°C pana la +30°C), intotdeauna la intuneric

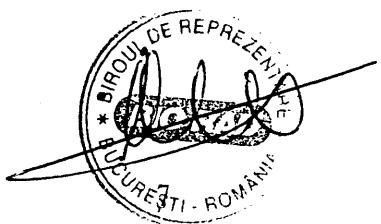

7 - PROBE

- ◆ Testul PLATELIA™ RABIES II a test a fost dezvoltat pentru aplicarea sa in cazul serului de provenienta animala (caini, pisici si vulpi).
- ◆ Testul este realizat pe ser diluat 1/100 in reactiv R6.
- ◆ Probele se pastreaza la +2° pana la +8°C daca detectia se realizeaza in interval de 24 ore de la recoltare sau pot fi pastrate 6 luni la -20°C. Probele pot fi supuse la 3 cicluri de congelare-decongelare. Probele congelate anterior trebuie omogenizate bine dupa decongelare, in vederea testarii.

NB : Eliminati prin centrifugare, daca este necesar particulele de fibrina sau agregatele din suspensie care ar putea sa genereze rezultate fals pozitive.

8 – PROTOCOLUL DE TESTARE

Se recomanda respectarea cu strictete a protocolului indicat.

Utilizati martorii pozitivi si negativ in fiecare microplaca pentru a valida calitatea detectiei in cazul unui test calitativ. Daca se doreste cuantificarea, martorul negativ si Standardele de cuantificare trebuie aplicate in fiecare placa. In ambele situatii este indicata respectarea configuratiei placii recomandata in trusa.

Se recomanda respectarea bunelor practici de laborator.


1. Extrageti din ambalajul protector suportul pentru microplaca si numarul necesar de barete (R1). Puneti baretele nefolosite si pachetul cu substanta deshidratanta inapoi in ambalaj si inchideti-l ermetic.
2. Stabiliti cu atentie distribuirea si identificarea probelor in placa, dupa cum urmeaza:

Configuratia microplacii pentru testul calitativ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	R3	E3										
B	R3	E4										
C	R4a	E5										
D	R4a	E6										
E	R4b	E7										
F	R4b	E8										
G	E1	E9										
H	E2	E10...										

Configuratia microplacii pentru testul cantitativ:


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	R3	S4	E1	E9								
B	R3	S4	E2	E10..								
C	R4a	S3	E3									
D	R4a	S3	E4									
E	S6	S2	E5									
F	S6	S2	E6									
G	S5	S1	E7									
H	S5	S1	E8									



3. Pentru testul calitativ diluati martorii R3, R4a si R4b si serurile de testat 1/100 in reactiv R6 (de ex.: 10 µl proba in 990 µl solutie de diluant).
4. Pentru testul cantitativ preparati Standardele de Cuantificare (a se vedea capitolul 5.3) si diluati martorii R3, R4a si serurile de testat 1/100 in reactiv (de ex.: 10 µl proba in 990 µl solutie de diluant).
5. Distribuiti 100 µl de probe diluate, martori si Standarde de Cuantificare in godeurile corespunzatoare ale microplacii, conform configuratiei prestabilitoare.
6. Acoperiti microplaca cu folie adeziva (taiati foliile daca este necesar). Presati puternic pe toata suprafata placii pentru a asigura sigilarea ermetica.
7. Incubati baretele la $37 \pm 2^\circ\text{C}$ timp de 60 minute ± 5 minute.
8. Preparati solutia de spalare (R2) [a se vedea capitolul 5]
9. Preparati solutia de conjugat (R7), dupa cum este descris in capitolul 5, inainte de sfarsitul primei perioade de incubare.
10. Inlaturati folia adeziva. Efectuati 3 cicluri de spalare. Conditii optime de spalare se intrunesc atunci cand se utilizeaza spalatoarele de microplaci Bio-Rad, de tip PW40, PW41 sau 1575, cu programul TSE 3. Nu lasati microplacile sa stea mai mult de 5 minute dupa ultimul ciclu de spalare. Uscati placa prin rasturnare pe hartie absorbanta inainte de a trece la etapa urmatoare.
11. Distribuiti 100 µl solutie de conjugat (R7) in fiecare godeu. Acoperiti placa cu o folie adeziva noua si incubati timp de 60 minute ± 5 minute la $37 \pm 2^\circ\text{C}$.
12. Preparati solutia de developare enzimatica (R8+R9) dupa cum este desctribat in capitolul 5, chiar inainte de utilizare.
13. Inlaturati folia adeziva, efectuati 5 cicluri de spalare. Conditii optime de spalare se obtin folosind spalatoarele de placi Bio-Rad PW40, PW41 sau 1575 cu programul TSE 5. Nu lasati microplaca sa stea mai mult de 5 minute dupa ultimul ciclu de spalare. Uscati placa prin rasturnare pe hartie absorbanta inainte de a trece la etapa urmatoare.
14. Departe de lumina directa distribuiti rapid 100 µl solutie de developare enzimatica (R8 + R9) in fiecare godeu si incubati placa la intuneric, la temperatura camerei ($+18$ pana la $+30^\circ\text{C}$) timp de 30 minute ± 5 minute.

NB: Nu utilizati folie adeziva in timpul acestei etape de incubare.

15. Adaugati 100 µl solutie de stopare (R10) in fiecare godeu, respectand aceeasi secventa si aceeasi rata de distributie ca in cazul solutiei de revelare.
16. Stergeti cu atentie fundul microplacii. Cititi densitatea optica la 450 nm – 620 nm (Modul de citire la dubla lungime de unda) in interval de 30 minute dupa stoparea reactiei (baretele trebuie sa fie intotdeauna protejate de lumina inainte de a efectua citirea).
17. Inainte de a inregistra rezultatele verificati daca citirile corespund planului de distributie si identificare a placii si probelor (configuratie placii).



Parametrii spalatorului de microplaci

NUME: TSE 3


EDIT Mode fincion	PLATE	Manifold	STRIPS	Met. (Method)	MODE	CROS SW ASP.	ASP. TIME	VOLUME FLOW	OVER FLOW	LIQUID FLOW	BOT. WASH NUMBER	BOT. ASp. NUMBER	SHAKE TIME	Nr OF CYCLES	SOAKING	MET. INTER	Nr OF KITS	KIT INTER
Main parameter	Flat 01 (PW40/PW41)	1*8 (PW40/1575)	1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10,11,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Flat 03 (1575)	2*8 (PW41)																
Method 1	-	-	WASH	Plate	Yes	0,3	800	2,5	W1	0	-	-	-	3	45 (PW40/1575)	0	-	
Method 2	-	-	BOTTOM ASP.	Plate	Yes	0,3	-	-	-	-	1	-	1	0	-	-	-	

NUME: TSE 5

EDIT Mode fincion	PLATE	Manifold	STRIPS	Met. (Method)	MODE	CROS SW ASP.	ASP. TIME	VOLUME FLOW	OVER FLOW	LIQUID FLOW	BOT. WASH NUMBER	BOT. ASp. NUMBER	SHAKE TIME	Nr OF CYCLES	SOAKING	MET. INTER	Nr OF KITS	KIT INTER
Main parameter	Flat 01 (PW40/PW41)	1*8 (PW40/1575)	1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10,11,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Flat 03 (1575)	2*8 (PW41)																
Method 1	-	-	WASH	Plate	Yes	0,3	800	2,5	W1	0	-	-	-	5	45 (PW40/1575)	0	-	
Method 2	-	-	BOTTOM ASP.	Plate	Yes	0,3	-	-	-	-	1	-	1	0	-	-	-	

NUME PLACA: FLAT 01 (PW40 / PW41) – FLAT 03 (1575)

BOT.	ASP. HOR. POS.	CENTERING	ASP. VER. POS.	BOT VERT. POS.	B.W. VERT. POS.	HORIZONTAL SPEED	VERTICAL SPEED	ASP. DOWNW. SPEED	DISP. UPW. SPEED	BOT. UPWARD SPEED	SHAKING AMPLITUDE	SHAKING FREQUENCY
1,4	0,3	13,5	9,5	9,5	8	6	9	6	9	9	45	30 (PW41)



9 – CALCULAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR


Rezultatele sunt redate ca Densitati Optice (DO) dupa citirea microplacii la 450 - 620 nm.

1. Determinare calitativa

Pentru determinarea calitativa trebuie inclusi toti martorii (R3, R4a si R4b) pentru fiecare runda de testare.

a) Conditii de validare

Criterii	Validare
DO R3(i) < 0.05	Absorbanta individuala a fiecarui martor negativ trebuie sa fie mai mica decat 0.05. Testul trebuie repetat daca cel putin una dintre valorile obtinute se situeaza in afara acestei limite.
0.300 ≤ DO R4a(i) ≤ 1.200	Fiecare valoare individuala a DO corespunzatoare martorului pozitiv R4a trebuie sa se incadreze intre 0.300 si 1.200 . Testul trebuie repetat daca cel putin una dintre valorile OD corespunzatoare lui R4a se situeaza in afara acestei limite.
1.500 ≤ DO R4b(i) ≤ 3.500	Fiecare valoare individuala a densitatilor optice corespunzatoare martorului pozitiv R4b trebuie sa se incadreze intre 1.500 si 3.500. Totusi, cel mult o valoare individuala neconcordanta poate fi eliminata, in cazul in care denisitatea sa optica este mai mica decat 1.500 sau mai mare decat 3.500. Testul trebuie repetat daca doua dintre valorile DO corespunzatoare martorului pozitiv R4b se situeaza in afara acestei limite.



b) Interpretarea rezultatelor

Valoarea Prag este egala cu media celor doi Martori Pozitivi R4a (DO R4a) si corespunde valorii prag de protectie la valoarea de 0,5 EU/ml.

Valoarea de Protectie Ridicata este egala cu media celor doi Martori Pozitivi R4b (DO R4b).

Densitatea Optica pentru fiecare proba este comparata cu aceasta Valoare de Protectie Ridicata si cu Valoarea Prag.


Status	Rezultat	Interpretare
Protectie +++	DO proba > DO R4b	Probele cu valoarea DO mai mare decat Valoarea de Protectie Ridicata provin de la indivizi cu un nivel inalt de protectie fata de infectia cu virius rabic, conform testului PLATELIA™ RABIES II.
Protectie	DO R4a ≤ DO proba ≤ DO R4b	Probele cu valoarea DO mai mare sau egala cu Valoarea Prag si mai mica sau egala cu valoarea de Protectie Ridicata provin de la indivizi protejati in urma vaccinarii, conform testului PLATELIA™ RABIES II.
Protectie absenta	DO proba < DO R4a	Probele cu valoarea DO mai mica decat Valoarea Prag provin de la indivizi care prezinta un nivel de anticorpi anti-rabici insuficient pentru a confirma eficienta vaccinarii conform testului PLATELIA™ RABIES II.


2. Determinarea cantitativa

Pentru determinarea cantitativa, fiecare runda de testare trebuie sa includa toate standardele si toti martorii (S1 pana la S6, R3 si R4a).

a) Conditii de validare

Criterii	Validare
DO R3(i) < 0.05	Absorbanta individuala a fiecarui martor negativ trebuie sa fie mai mica decat 0.05. Testul trebuie repetat daca cel putin una dintre valori se situeaza in afara limitei.
0.300 ≤ DO R4a(i) ≤ 1.200	Fiecare valoare individuala a densitatilor optice corespunzatoare martorului pozitiv R4a trebuie sa se situeze intre 0.300 si 1.200. Testul trebuie repetat daca cel putin una dintre valorile DO corespunzatoare lui R4a se situeaza in afara acestei limite.



 <u>S1 < S2 < S3 < S4 < S5 < S6</u>	<p>Calculati valoarea medie a DO pentru S1 pana la S6 in urmatorul mod:</p> <p><u>S1</u> = media a doua valori OD pentru S1 (corespunde la 0.125 EU/ml)</p> <p><u>S2</u> = media a doua valori OD pentru S2 (corespunde la 0.25 EU/ml) etc...</p> <p>Semnalele standardelor trebuie sa acreasca in mainiera urmatoare:</p> <p><u>S1 < S2 < S3 < S4 < S5 < S6</u></p>
<u>0.7 ≤ S3/R4a DO ≤ 1.3</u>	<p>Raportul dintre <u>S3</u> (valoarea medie a standardului S3) si <u>R4a</u> (media R4a) trebuie sa se situeze intre 0.7 si 1.3</p>

b) Interpretarea rezultatelor

Valoarea Prag este egala cu media celor doua valori DO ale Standardului de Cuantificare S3 (S3). Standardul de Cuantificare S3 corespunde valorii prag de protectie de 0.5 EU/ml.

Cantitatea de aniticorpi anti-rabie din proba este determinata prin compararea dintre densitatea optica a probei si curba standard.


Titrurile serurilor sunt exprimate ca Unitati Echivalente la 1ml (EU/ml), unitate echivalenta cu unitatile internationale definite prin seroneutralizare.

Trasarea curbei standard:

Pentru reducerea manuala a datelor folositi hartie milimetrica si reprezentati grafic valorile medii ale citirilor DO corespunzatoare Standardelor de Cuantificare (S1 la S6) pe axa verticala (y). Proiectati concentratiile corespunzatoare in EU/ml pe axa orizontala (x). Trasati curba standard prin cele 6 puncte.

Pentru reducerea automata a datelor cea mai uniforma interpolare se obtine utilizand o functie spline, pentru a construi curba bazata pe citirile valorilor DO corespunzatoare standardelor.

Poate fi furnizat un rezultat cantitativ pentru titrul anticorpilor anti-rabie in cazul unei probe necunoscute daca valoarea DO a probei se situeaza intre valorile medii ale densitatilor optice pentru S1 (0,125 EU/ml) si S6 (4 EU/ml). In acest caz, titrul probei necunoscute este determinat pe baza Curbei Standard. Gasiti valoarea corespunzatoare valorii DO a probei pe axa y si trasati o linie orizontala pana la Curba Standard. La punctul de intersectie cu Curba Standard coborati o linie verticala la axa x. Cititi valoarea corespunzatoare a concentratiei anticorpilor in EU/ml.

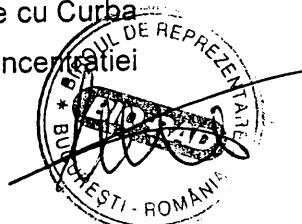

Daca valoarea DO a probei necunoscute este mai mare decat valoarea medie a Densitatii Optice pentru standardul S6, in acest caz nu se poate realiza o cunatificare precisa. Daca se doreste o cuantificare precisa, realizati o dilutie de cel putin 1/10 a probei si efectuati testul din nou, pentru a obtine o Densitate Optica incadrata in intervalul Curbei Standard.

*DESENUL DE REFERINTA
TESTUL RABIES QT ELISA BIO-RAD*

TESTUL RABIES QT ELISA BIO-RAD

NOTA: O interpretare si o modalitate de conversie a valorilor DO in titru de anticorpi se gasesc pe CD (RabiesQT-ELISA BIO-RAD – Vers.200712.A.XLS) pentru utilizatori care nu sunt echipati cu cititoare de microplaci Bio-Rad. Pentru informatii contactati Bio-Rad, Reprezentanta pentru Romania.

Explicatii generale asupra rezultatelor :

Rezultate exprimate ca Densitati Optice pentru probe necunoscute	Titrul probei necunoscute (X)	Interpretarea rezultatelor
DO proba > S6	X > 4 EU/ ml	Nivel ridicat de protectie. Daca este necesar un titru precis, proba trebuie diluata inainte de repetarea testului.
S3 ≤ DO proba ≤ S6	X in EU/ml (0,5 – 4 EU/ml)	Nivel suficient de protectie.
S1 ≤ DO proba ≤ S3	X in EU/ml (0,125-0,5 EU/ml)	Seroconversie insuficienta (individ neprotejat), conform testului PLATELIA™ RABIES II
DO proba < S1	-	Individ neprotejat


10 – LIMITELE TESTULUI

Un nivel de seroconversie insuficient sau nedetectabil poate fi raportat in cazul animalelor vaccinate recent, datorita unui raspuns imun intarziat. Similar metodei oficiale de titrare a anticorpilor neutralizanti, conform reglementarii (EC) Nr. 998 / 2003 valabila de la 3 iulie 2004, se recomanda efectuarea testului PLATELIA™ RABIES II in cazul probelor de ser prelevate cel mai curand la 30 zile dupa vaccinare.

11 – ECHIPAMENTE SI MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE IN TRUSA

Echipamente

- Cititor de placi prevazut cu filtre de 450 si 620 nm (*)
- Incubator de microplaci programat la $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.





Spalator de microplaci manual, semi-automat sau automat (*)

Agitator tip Vortex

(*) Contactati Bio-Rad, Reprezentanta pentru Romania pentru informatii detaliate referitoare la instrumentele Bio-Rad validate de departamentul nostru tehnic.

Materiale


- ◆ Pipete automate sau semi-automate, ajustabile sau fixe pentru masurarea si distribuirea unor volume de 10 - 1000 µl si 1, 2 si 10 ml.
- ◆ Cilindrii gradati de 25 ml, 50 ml, 100 ml, si 1 000 ml
- ◆ Eprubete de unica folosinta.
- ◆ Apa distilata sau deionizata
- ◆ Hipoclorit de sodiu
- ◆ Hartie absorbanta
- ◆ Masti sau ochelari de protectie
- ◆ Manusi de unica folosinta din latex
- ◆ Container pentru reziduuri cu risc biologic

12 – MASURI DE PRECAUTIE

1. Masuri de precautie

Calitatea rezultatelor depinde de aplicarea corecta a urmatoarelor bune practici de laborator:

- ◆ Reactivii trebuie pastrati la o temperatura intre +2°C si +8°C
- ◆ Nu folositi reactivi expirati.
- ◆ Nu combinati reactivi din loturi diferite in cadrul unei runde de testare, cu exceptia reactivilor de uz general R2, R8, R9, R10.
- ◆ Inainte de utilizare asteptati 30 minute pana cand reactivii ajung la temperatura camerei.
- ◆ Reconstituiti reactivii cu atentie, evitand orice contaminare.
- ◆ Nu efectuati testul in prezenta vaporilor inflamabili (acizi, alkali, aldehyde) sau a prafului care ar putea altera activitatea enzimei din cadrul conjugatului.
- ◆ Utilizati sticlarie spalata cu atentie si clatita cu apa deionizata sau preferabil, consumabile de unica folosinta.
- ◆ Nu lasati microplaca sa stea mai mult de 5 minute intre sfarsitul etapei de spalare si distribuirea reactivilor in placa.
- ◆ Verificati precizia pipetarii si buna functionare a aparatului utilizat.
- ◆ Nu folositi niciodata acelasi recipient pentru distribuirea conjugatului si a solutiei de developare.



- ♦ Reactia enzimatica este foarte sensibila la prezenta metalelor sau a ionilor metalici. In consecinta, nu lasati un element metalic sa vina in contact cu solutiile de conjugat sau de substrat.
- ♦ Solutia de developare (tampon substrat + cromogen) trebuie sa fie ~~incolore~~. Aparitia unei culori albastre in cateva minute de la reconstituirea solutiei de developare indica faptul ca reactivul nu poate fi utilizat si trebuie inlocuit. Prepararea acestei solutii se poate face intr-o tavita curata de plastic, de unica folosinta sau intr-un recipient de sticla care a fost spalat in prealabil cu HCl 1N, si clatit cu atentie cu apa distilata si apoi uscat. Solutia trebuie tinuta la intuneric.
- ♦ Utilizati un varf nou de pipeta pentru fiecare proba.
- ♦ Nu modificati procedura de testare.
- ♦ Spalarea godeurilor reprezinta o etapa cruciala in cadrul metodei: respectati numarul de cicluri de spalare recomandat si asigurati-vă de faptul ca godeurile sunt complet umplute, iar apoi golite. Spalarea neadecvata poate genera rezultate incorecte.

2. Instructiuni de igiena si siguranta


In general, conditiile de igiena, masurile de biosecuritate si bunele practici de laborator trebuie sa fie in concordanta cu reglementarile autoritatilor nationale.

Totii reactivii din trusa sunt destinati diagnosticului veterinar "in vitro" – pentru seruri de caine, pisica si vulpe.

- ♦ Purtati manusi de unica folosinta atunci cand manipulati reactivii si probele. Spalati mainile riguros dupa ce manevrati probe si reactivi.
- ♦ Nu pipetati cu gura.
- ♦ Considerati orice material aflat in contact direct cu probele si reactivii, precum si solutiile de spalare drept material infectios.
- ♦ Evitati varsarea probelor sau a solutiilor care contin probe.
- ♦ Stropirile accidentale pot fi clatite cu solutie de hipoclorit diluat 10%. Daca lichidul contaminant este acid, zona stropita trebuie intai neutralizata cu bicarbonat de sodiu, apoi curatata cu hipoclorit si uscata cu hartie absorbanta. Materialul folosit pentru curatare trebuie inlaturat dupa decontaminare.
- ♦ Probele si materialele si produsele contaminate ar trebui sa fie eliminate dupa decontaminare.
 - Fie prin imersie in hipoclorit la o concentratie finala de 5% hipoclorit de sodiu, timp de 30 min.
 - Fie prin autoclavare la 121°C timp de cel putin 2 ore.

Atentie: Nu introduceti solutii care contin hipoclorit de sodiu in autoclav.

- ♦ Substantele chimice trebuie manipulate si eliminate in conformitate cu Bunele Practici de Laborator.






Reactivii care contin ProClin™300 0.1% sunt clasificati ca substante iritante conform legislatiei europene.



Xi
(0.1% ProClin™ 300)

R: 43 Poate cauza sensibilitate de contact

S: 28 – 37 La contactul accidental cu pielea spalati imediat cu apa din abundenta. Purtati manusi de laborator corespunzatoare.



PLATELIA™ RABIES II KIT Pentru uz veterinar

3550180

Detectia si titrarea IgG anti-rabies din séră

192 test

R1 Microplaca 2X4	R6 Diluant pentru probă	2 X 125 ml
R2 Solutie de spalare concentrata 1X 250 ml	R7 Complet concentrat	1X3 ml
R3 Martor negativ	R8 Ampoule substraat pentru peroxidaza	1X 60 ml
R4a Martor pozitiv (caine) 0.5 EU/ml 1X 0.6 ml	R9 Cromogen MB	1X 5 ml
R4b Martor pozitiv (caine) 4EU/ml 1X 0.6 ml	R10 Solutie de stopante	1X 28 ml

XI
R: 43
S: 28.37
0.1% ProGin™ 300



PLATELIA RABIES II KIT Pentru uz veterinar

3550180

R1 LOT OK0036 exp 2012-04-30	R4b LOT OL0020 exp 2012-05-15	R8 LOT OK0387 exp 2012-04-30
20101036300412	20242020150512	20103347300412
R2 LOT OL0059 exp 2012-05-15	R6 LOT OL0031 exp 2012-05-15	R9 LOT OK0276 exp 2012-04-30
20102059150512	20106031150512	20109276300412
R3 LOT OL0031 exp 2012-05-15	R7 LOT OL0043 exp 2012-05-15	R10 LOT OK0323 exp 2012-10-30
20103031150512	20107043150512	20110323301012
R4a LOT OL0020 exp 2012-05-15	LOT OL0020 exp 2012-04-30	
20241020150512	P501801TOL0020	

